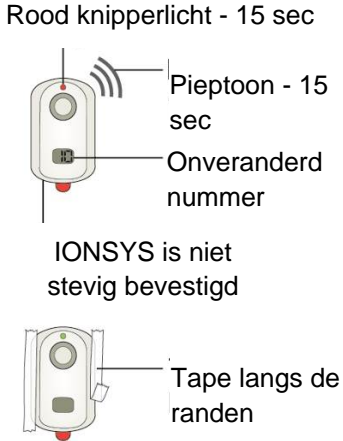
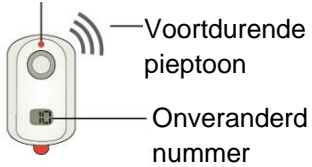

 <p>No light</p> <p>Geen pieptoon</p> <p>Scherm werkt niet</p>		<p>plaats op de huid</p>
 <p>Rood knipperlicht - 15 sec</p> <p>Pieptoon - 15 sec</p> <p>Onveranderd nummer</p> <p>IONSYS is niet stevig bevestigd</p> <p>Tape langs de randen</p>	<p>Slecht contact met de huid</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Als het IONSYS-systeem los lijkt te komen of de huid niet voldoende raakt, bevestig het dan tegen de huid van de patiënt door de randen stevig aan te drukken of door een niet-allergene tape te gebruiken. 2. Als u tape gebruikt, bevestig u die langs de randen van het IONSYS-systeem en mag u de doseerknop of het scherm niet afdekken. 3. Als het systeem opnieuw een pieptoon geeft, verwijder het systeem en voer het af en plaats een nieuw systeem op een andere plek van de huid
 <p>Rood knipperlichtje</p> <p>Voortdurende pieptoon</p> <p>Onveranderd nummer</p>	<p>Systeemfout</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het systeem bij de patiënt 2. Houd de doseerknop ingedrukt totdat het piepen stopt en het scherm wordt uitgeschakeld 3. Voer het systeem af zoals hierboven wordt aangegeven in Stap 5 - IONSYS verwijderen en afvoeren. 4. Plaats een nieuw systeem op een andere plaats op de huid
 <p>Geen lichtje</p> <p>Geen pieptoon</p> <p>Flikkerend nummer</p>	<p>Einde van het gebruik na 24 uur of 80 doses</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verwijder het systeem bij de patiënt 2. Houd de doseerknop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld 3. Voer het systeem af zoals hierboven wordt aangegeven in Stap 5 - IONSYS verwijderen en afvoeren. 4. Plaats een nieuw systeem op een andere plaats op de huid

Als een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg een defect of storing vermoedt, moet IONSYS onmiddellijk bij de patiënt worden verwijderd en moet onmiddellijk contact worden opgenomen met The Medicines Company.

De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg moet ervoor zorgen dat de patiënt begrijpt dat hij/zij onmiddellijk een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg moet inlichten bij een vermoeden van storing of defect.